



MUMT  
盟洲醫材

# 製氧機 X51

— 操作說明 —

## 產品基本裝箱清單

- 1 盟洲製氧機 X51\*1台**
- 2 潮濕瓶\*1個**
- 3 潮濕瓶連接管\*1條**
- 4 鼻氧管\*1條**
- 5 產品使用手冊\*1本**



# X51製氧機身外觀

機身正面



機身背面



# 產品零部件介紹

MJMT  
盟洲醫材

顯示面板 流量調節閥 電源開關



霧化功能接口 氧氣輸出口




潮濕瓶放置處

# 操作步驟說明

## 步驟1

將連接管&鼻氧管接上潮濕瓶 裝上機身

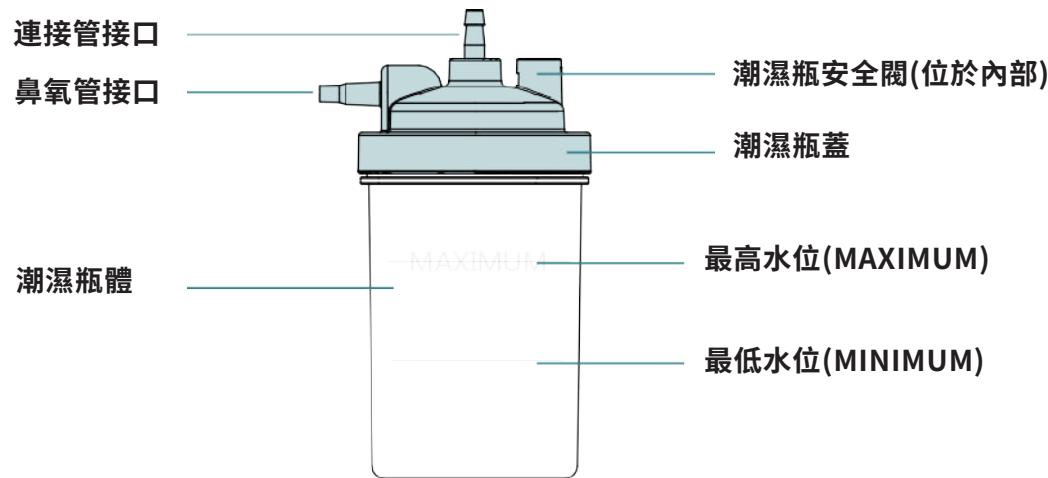

\*潮濕瓶內建議使用純水、蒸餾水

\*瓶內水需每日更換

\*水量約瓶身1/2 (介於最低&最高水位之間)




# 操作步驟說明

MJMT  
盟洲醫材

## 步驟2

插上電源插頭，保持室內空氣流通,機身離牆至少30cm  
底部淨空，確保機器散熱正常

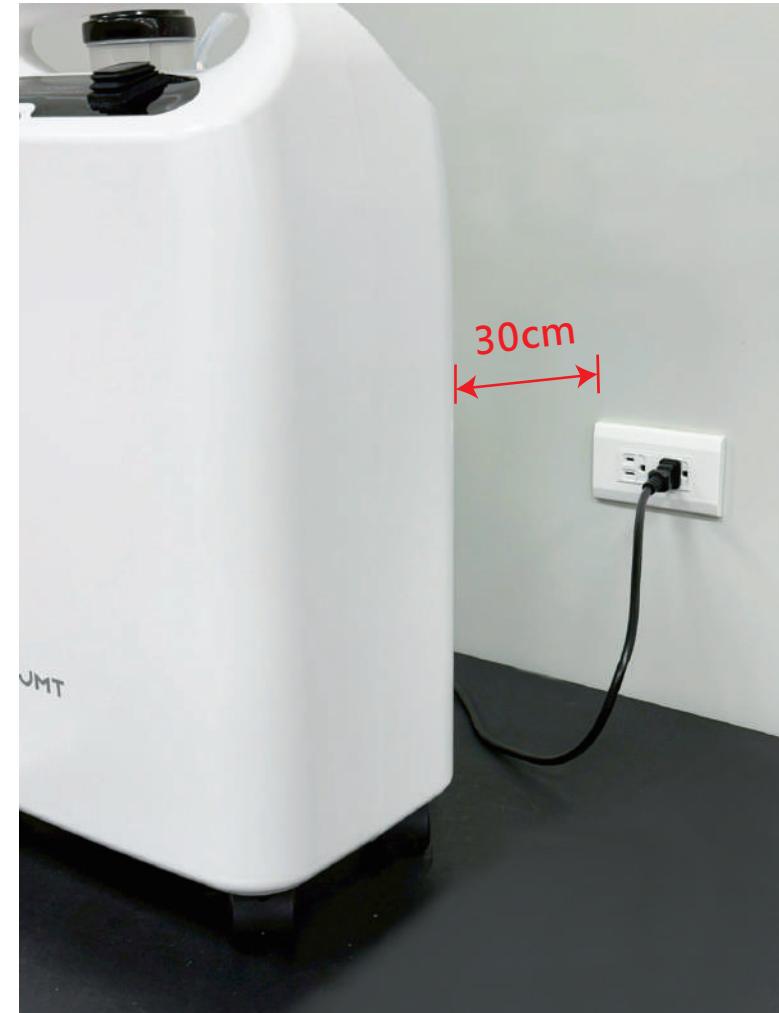

\*請勿使用延長線 / 需獨立電源使用

# 操作步驟說明

MJMT  
盟洲醫材

# 步驟3


## 開啟電源 / 調整流量(依醫囑調整)



\*流量浮球調整勿低於1L或高於紅線

\*關機步驟:將流量計調整歸零→關閉電源→拔除插頭

## 顯示螢幕指示

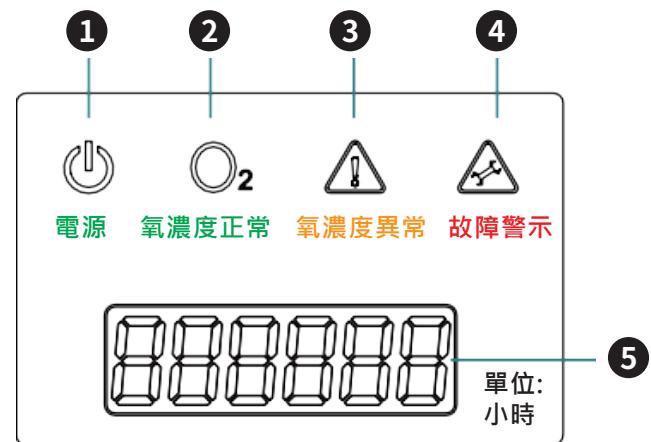

- ① 綠色電源指示燈-機器運轉正常
  - ② 綠色正常指示燈-氧氣輸出正常
  - ③ 黃色低氧指示燈-氧氣輸出濃度低
  - ④ 紅色服務指示燈-聯繫維修服務
  - ⑤ 機器運轉時數累計顯示

# 鼻氧管使用說明

## 步驟1

將鼻氧管前端的兩個小管確認方向（彎口朝下）  
準備放入鼻孔前，先檢查管路是否扭曲

## 步驟2

將兩個小管輕輕放入鼻孔  
管線沿著臉頰向兩側拉到耳朵上方固定



## 步驟3

將管線繞過耳後，在下巴下方調整滑扣，固定鬆緊度  
(以不壓迫、不滑落為原則)



\*小提醒

鼻氧管輕放即可，若感覺鼻腔乾燥，可搭配潮濕瓶使用。

# 霧化套件介紹

MJMT  
盟洲醫材



\*霧化套件組可依需求自行額外選購

噴霧吸嘴組裝示意圖



氧氣面罩組裝示意圖



# 霧化套件使用說明

MJMT  
盟洲醫材



## 進氣過濾棉清潔

1 過濾棉卡槽位於機身背面



2 將過濾棉卡槽拆卸



3 將過濾棉取出清潔



進氣過濾棉：建議每個月至少2次，將機殼打開取出過濾棉，用清潔劑及清水清潔後，放置空氣中自然乾燥，待乾透後，裝回繼續使用。

## 進氣過濾器更換

過濾器位於過濾棉卡槽後方，需先將過濾棉卡槽卸下，自行定期更換即可。



機器內部進氣過濾器**不可**用水清洗，建議約3000小時或一年可以更換新過濾器

\*自行水洗將造成機器內部受潮或損壞。