



MJMT

盟洲醫材

# 製氧機 X52

— 操作說明 —

**MJMT**

盟洲醫材

## 產品基本裝箱清單

- 1 盟洲製氧機 X52\*1台
- 2 潤濕瓶\*1個
- 3 鼻氧管\*1條
- 4 產品使用手冊\*1本



# X52製氧機身外觀

MJUMT  
盟 洲 醫 材

機身正面



機身背面



\*使用前請將底部束帶移除

## 數位觸控顯示面板




潮濕瓶放置處

霧化功能接口

氧氣輸出口

開關機鍵

## 步驟1 將潮濕瓶&鼻氧管 裝上機身

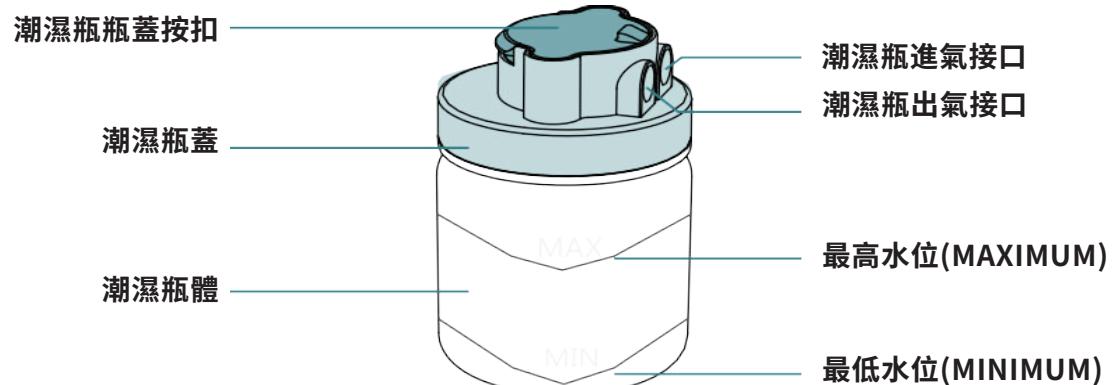

- \*潮濕瓶內建議使用純水、蒸餾水
- \*瓶內水需每日更換
- \*水量約瓶身1/2 (介於最低&最高水位之間)

## 步驟2

插上電源插頭，啟動總電源，保持室內空氣流通，  
機身離牆至少30cm，底部淨空，確保機器散熱正常



\*請勿使用延長線 / 需獨立電源使用

## 步驟3 按下開機鍵 / 觸控調整流量(依醫囑調整)



\*關機步驟: 按關機鍵→關總電源→拔除插頭

# 鼻氧管使用說明

## 步驟1

將鼻氧管前端的兩個小管確認方向（彎口朝下）  
準備放入鼻孔前，先檢查管路是否扭曲

## 步驟2

將兩個小管輕輕放入鼻孔  
管線沿著臉頰向兩側拉到耳朵上方固定



## 步驟3

將管線繞過耳後，在下巴下方調整滑扣，固定鬆緊度  
(以不壓迫、不滑落為原則)



### \*小提醒

鼻氧管輕放即可，若感覺鼻腔乾燥，可搭配潮濕瓶使用。


# 霧化套件介紹

MJMT  
盟洲醫材



\*霧化套件組可依需求自行額外選購

噴霧吸嘴組裝示意圖

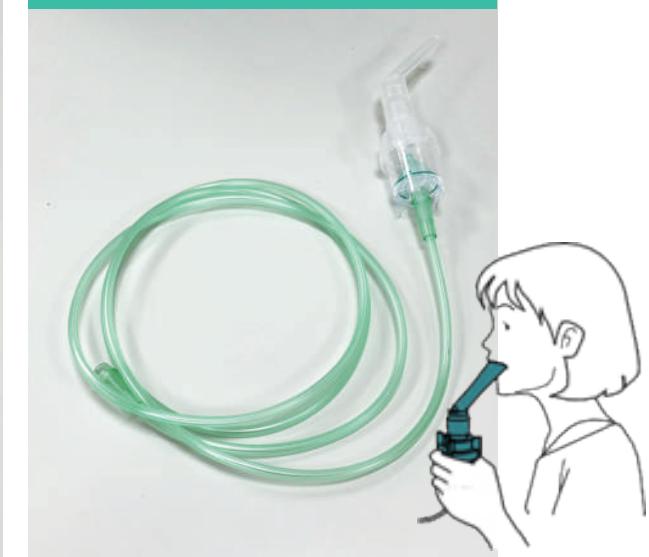

氧氣面罩組裝示意圖



# 霧化套件使用說明

## 藥劑添入霧化杯



## 蓋上霧化杯蓋



## 接上面罩&氧管



逆時針轉開



霧化接口開啟



接上霧化套件



### 1 過濾棉位於機身側邊



### 2 將過濾棉取出清潔



進氣過濾棉：建議每個月至少2次，將機殼打開取出過濾棉，用清潔劑及清水清潔後，放置空氣中自然乾燥，待乾透後，裝回繼續使用。

## 進氣過濾器更換

過濾器位於機身側邊,拆開外蓋後,自行定期更換即可。



機器內部進氣過濾器**不可**用水清洗,建議約3000小時或一年可以更換新過濾器。

\*自行水洗將造成機器內部受潮或損壞。